


Ajuste Correto dos Detectores Imunes a Animais Domésticos

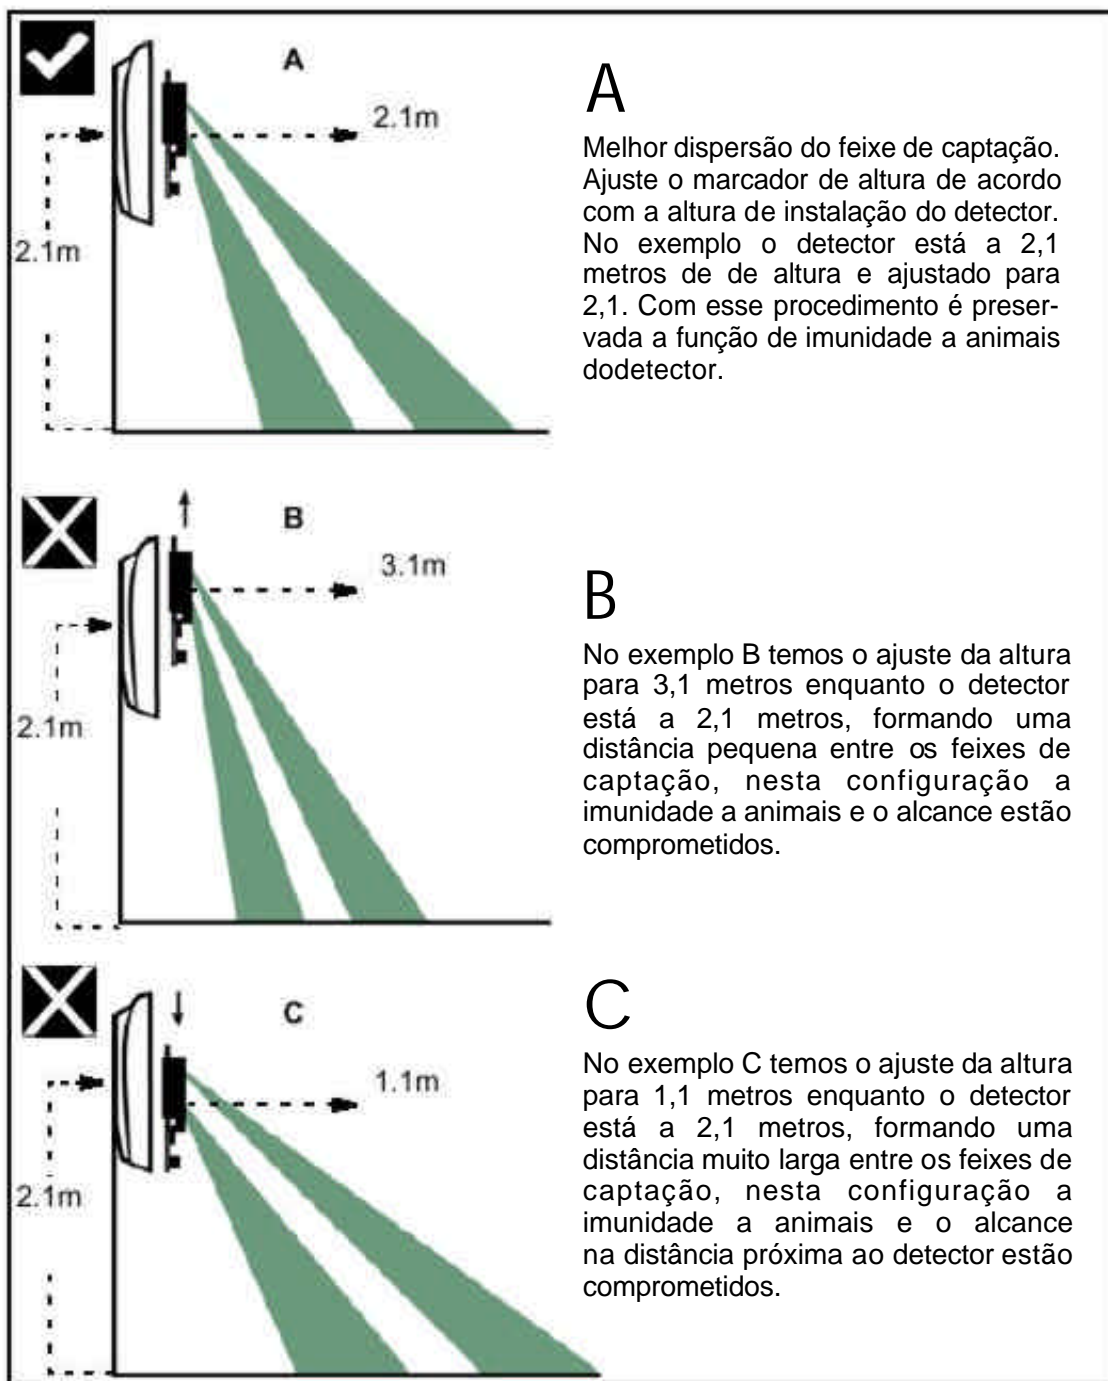

Esta recomendação aplica-se aos detectores DG-75, DG-85 e PMD-75